Kraków, dnia 18.05.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_3

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy – nr ZP/1/2026

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 11.05.2026 r., SPZOZ w Skale udziela niniejszym wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie oferenta:

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie kompletu dokumentów technicznych Zamawiającego, obejmujących: aktualny projekt osłon stałych (+ informacja o planowanej ilości wykonywanych ekspozycji w ujęciu miesięcznym) rzut pionowy pracowni RTG, przekrój poprzeczny pracowni RTG, informację dotyczące materiału z jakiego wykonany jest strop oraz jaka jest wysokość pomieszczenia RTG (dodatkowo poprosimy o informację, czy strop jest w stanie umożliwiającym montaż aparatu RTG), plan ułożenia kanałów podłogowych, plan instalacji elektrycznych, informacje na temat dostępnego przyłącza, w tym rodzaju i wartości zastosowanych bezpieczników oraz przekroju kabla zasilającego, informacji o dostawcy PACS, dostępności licencji oraz przewidywanych kosztów jakie musi ponieść Wykonawca (w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji w której potencjalni wykonawcy nie zostaną potraktowani w przez dostawce PACS w sposób jednakowy). Prosimy również o wyznaczenie terminu wizji lokalnej, aby ocenić zakres ew. prac adaptacyjnych i pozostałych aspektów w tym logistyki i ew. demontażu obecnie funkcjonującego aparatu. Udostępnienie powyższych materiałów jest dla nas niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty oraz rzetelnego oszacowania zakresu prac adaptacyjnych.

Jednocześnie, w związku z wymogiem przedstawienia oficjalnych broszur produktowych w celu potwierdzenia spełniania wszystkich parametrów określonych w OPZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie dopuszczalnej formy ich potwierdzenia. Z uwagi na bardzo rozbudowany i szczegółowy charakter OPZ, pragniemy wskazać, iż w praktyce nie istnieją oficjalne materiały producenta (katalogi, broszury), które w sposób jednoznaczny i kompletny potwierdzają każdy z wymaganych parametrów, w szczególności w zakresie: – funkcjonalności oprogramowania, – szczegółowych elementów wyposażenia (np. liczby portów USB w stacji technika), – parametrów konfiguracyjnych zależnych od indywidualnej specyfikacji systemu. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści potwierdzenie spełniania wskazanych parametrów w formie: – podpisanego oświadczenia producenta lub – podpisanego oświadczenia autoryzowanego dystrybutora, wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym

autoryzację (list autoryzacyjny producenta). Proponowane rozwiązanie jest zgodne z praktyką rynkową oraz umożliwia rzetelne i jednoznaczne potwierdzenie spełniania wszystkich wymagań określonych w OPZ.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż planowana liczba wykonywanych ekspozycji wynosi co najmniej 800 ekspozycji miesięcznie. Zamawiający wyjaśnia również, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę cyfrowego aparatu RTG wyposażonego w kolumnę teleskopową montowaną do podłogi. Kołpak z lampą RTG oraz kolimator RTG mają być zamocowane na wysięgniku kolumny podłogowej, w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań przewidujących montaż aparatu RTG do stropu.

Zamawiający wskazuje ponadto, że szczegółowe informacje dotyczące dostępności licencji, warunków współpracy oraz ewentualnych kosztów związanych z integracją lub rozbudową systemu Wykonawcy mogą uzyskać bezpośrednio od dostawcy systemu PACS, tj. KONTROLA.pl s.c. **z siedzibą pod adresem: ul. Inowrocławska 5/129, 91-020 Łódź.**

Zamawiający przekazuje poniżej rzut Pracowni RTG zawierający oznaczenie osłon stałych oraz informacje dotyczące zastosowanych materiałów. Wszelkie pozostałe informacje niezbędne do przygotowania oferty Wykonawca powinien zweryfikować podczas wizji lokalnej, możliwej w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1) zmianie ulegają zapisy Sekcji VIII – PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE w ten sposób, że punkt 3) otrzymuje brzmienie:

3) Przedmiotowe środki dowodowe

tabela 2

*Zamawiający wymaga **złożenia wraz z ofertą** przedmiotowych środków dowodowych:* *1) CE i/ lub Deklaracja zgodności: produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności z dyrektywą MDD 93/42/EWG lub rozporządzeniem MDR 2017/745, a w pozostałych przypadkach odpowiedni Certyfikat CE i/ lub Deklarację zgodności, potwierdzające, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem;* *2) wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.* *3) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy i parametry określone w specyfikacji technicznej aparatu RTG (Załącznik_A_SWZ_specyfikacja_techniczna_RTG), Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą kart katalogowych, prospektów lub wyciągów z dokumentacji technicznej*

producenta oferowanego przedmiotu zamówienia; dokumenty, o których mowa, muszą jednoznacznie potwierdzać spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów technicznych w zakresie (numeracja poniżej zgodna ze Specyfikacją techniczną -zał. A do SWZ):

II GENERATOR RTG
1. Częstotliwość napięcia anodowego generatora ≥ 400 kHz
2. Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) ≥ 65 kW
7. Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms

III ***KOŁPAK Z LAMPĄ RTG I KOLIMATOR RTG ZAMOCOWANY NA WYSIĘGNIKU KOLUMNY PODŁOGOWEJ***
- Wielkość małego ogniska (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 0,6
4. Pojemność cieplna anody ≥ 600 kHU
6.Maksymalna szybkość chłodzenia anody ≥ 100 kHU/min
7. Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,7 MHU

IV. WOLNOSTOJĄCA KOLUMNA PODŁOGOWA RTG
3. Minimalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi ≤ 50 cm

V. UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY
6. Max. obciążenie blatu stołu ≥ 310 kg
8. Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi ≤ 55 cm
11. Pochłanialność blatu stołu - ekwiwalent Al ≤ 0,70 mm Al.

VI. STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
6. Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al ≤ 0,60 mm Al.
7. Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 50 mm

VII. DETEKTOR W STOJAKU PŁUCNYM - WBUDOWANY NA STAŁE LUB BEZPRZEWODOWY
(Dopuszcza się detektor w stojaku płucnym - bezprzewodowy, opisany jak pkt. VIII)
- Wielkość piksela ≤ 140 µm
- Współczynnik DQE dla 0 pl/mm ≥ 75%

VIII. CYFROWY DETEKTOR BEZPRZEWODOWY
2. Rozdzielczość detektora ≥ 3000 x 3000 pixel
7. Waga detektora z baterią ≤ 3,6 kg

IX. STACJA TECHNIKA RTG
5. Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu ≤ 6 s

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż dokumenty wymienione w ust. 3.

2) zmianie ulegają zapisy Sekcji XVII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY w ten sposób, że punkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą:

a. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b. Załącznik nr 2.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy,

c. *Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy,*

d. *Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą <u>przedmiotowych środków dowodowych:</u>*

i. *CE i/ lub Deklaracja zgodności: produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności z dyrektywą MDD 93/42/EWG lub rozporządzeniem MDR 2017/745, a w pozostałych przypadkach odpowiedni Certyfikat CE i/ lub Deklarację zgodności, potwierdzające, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem;*
ii. *wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.*
iii. *w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy i parametry określone w specyfikacji technicznej aparatu RTG (Załącznik_A_SWZ_specyfikacja_techniczna_RTG), Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą kart katalogowych, prospektów lub wyciągów z dokumentacji technicznej producenta oferowanego przedmiotu zamówienia; dokumenty, o których mowa, muszą jednoznacznie potwierdzać spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów technicznych w zakresie wskazanym w sekcji VIII pkt 3 SWZ).*

W związku z powyższym - działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) - Zamawiający dokonuje powyższej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert powoduje, że w SWZ ulegają zmianie następujące zapisy:

1) w Sekcji XII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM zmianie ulega ust.2, który otrzymuje brzmienie: *„Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 26.05.2026 r., godz. 10:00. „*

2) w Sekcji XIX – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT zmianie ulega ust.3, który otrzymuje następujące brzmienie: *„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 26.05.2026 r. do godz. 10:00, zgodnie z zasadami wskazanymi w Sekcji XIV na stronie internetowej prowadzonego postępowania."*

3) W Sekcji XX – TERMIN OTWARCIA OFERT zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: *„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie*

terminu składania ofert, tj. w dniu 26.05.2026 r. o godz. 10:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego."

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić ją przy sporządzaniu oferty; pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marzena Grochowska
Data: 2026.05.18 10:49:01 CEST

Marzena Grochowska


Dyrektor SPZOZ w Skale

……..

(w imieniu Zamawiającego)

Rzut Pracowni RTG



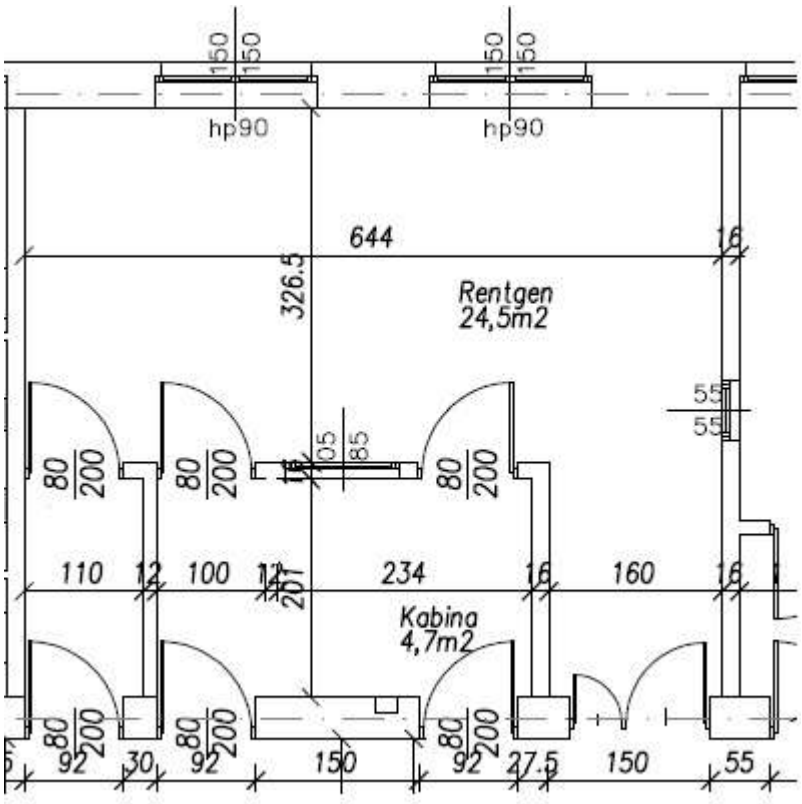

Osłona	**Materiał**
Ściana AB	Cegła pełna + 3,00 mm Pb
Ściana BC	Pustak MAX + 1,50 mm Pb
Ściana CD	Cegła pełna + 1,00 mm Pb
Ściana DE	Cegła pełna + 1,00 mm Pb
Ściana EFG	Cegła pełna + 1,00 mm Pb
Ściana GA	Cegła pełna + 1,00 mm Pb
Okno Ok1	Szkło + 2,00 mm Pb
Okno Ok2	Szkło + 2,00 mm Pb
Okno Ok3	Szkło + 2,00 mm Pb
Drzwi Dz1	Stolarka + 2,00 mm Pb
Drzwi Dz2	Stolarka + 2,00 mm Pb
Drzwi Dz3	Stolarka + 2,00 mm Pb
Drzwi Dz4	Stolarka + 2,00 mm Pb
Strop górny	Beton + 2,00 mm Pb
Strop dolny	brak możliwości przebywania - ziemia rodzima