Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21
38-300 Gorlice
e-mail: korygabartosz@szpital.gorlice.pl

26.08.2026 r.

Dotyczy postępowania pn.: Serwety operacyjne i fartuchy

Numer postępowania: 78/2026

Odpowiedzi na pytania – sprostowanie

Zamawiający powtórnie przeanalizował zapytania dotyczące zapisów SWZ odnośnie ww. postępowania, po rozpatrzeniu okoliczności, zmianie ulegają odpowiedzi na pytania dotyczące:

- Części nr 1 pozycje 1 – 4

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających w swoim składzie serwety wykonane w części niewzmocnionej z laminatu 2- warstwowego o odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 103 kPa? Pozostałe parametry bez zmian"

- Części nr 1 pozycje 2 – 3

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zawierających w swoim składzie serwetę główną wykonaną z laminatu 2 warstwowego posiadającą w obszarze wzmocnionym pad chłonny (materiał trzywarstwowy) z wiskozy o gramaturze całkowitej 130 g/m2 i odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 121 kPa (obszar niewzmoniony) i min. 243 kPa (obszar wzmocniony)?"

- Części nr 1 pozycja 5

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie fartuchy chirurgiczne wzmocnione o odporności na rozerwanie na mokro w obszarze wzmocnionym min. 174 kPa? Pozostałe parametry bez zmian."

- Części nr 5 pozycja 8

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo posiadającej wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145 cm?"

- Części nr 1 pozycja 5 oraz części nr 14 pozycje 1-7

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów sklasyfikowanych jako zestawy zabiegowe spełniające definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37?"

Zamawiający po ponownej analizie bieżącego zapotrzebowania zdecydował się na dopuszczenie rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę.
Zamawiający publikuje poniższą listę odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w ww. postępowaniu wraz z pierwotnie udzielonymi odpowiedziami oraz odpowiedziami do powyższych pytań po sprostowaniu.
W związku z zaistniałymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 28.08.2026 r. godz. 9:00 na 31.08.2026 r. godz. 9:00, natomiast otwarcie ofert zostaje przesunięte z 28.08.2026 r. godz. 9:30 na 31.08.2026 r. godz. 9:30.

Zadanie nr 1

Pytanie 1
Poz. nr 1-4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających w swoim składzie serwety wykonane w części niewzmocnionej z laminatu 2- warstwowego o odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 103 kPa? Pozostałe parametry bez zmian

~~Odp.: Jak w SWZ.~~

Odpowiedź po sprostowaniu: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2
Poz. nr 2-3- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zawierających w swoim składzie serwetę główną wykonaną z laminatu 2 warstwowego posiadającą w obszarze wzmocnionym pad chłonny (materiał trzywarstwowy) z wiskozy o gramaturze całkowitej 130 g/m2 i odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 121 kPa (obszar niewzmoniony) i min. 243 kPa (obszar wzmocniony)?

~~Odp.: Jak w SWZ.~~

Odpowiedź po sprostowaniu: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 3
Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie fartuchy chirurgiczne wzmocnione o odporności na rozerwanie na mokro w obszarze wzmocnionym min. 174 kPa? Pozostałe parametry bez zmian.

~~Odp.: Jak w SWZ~~

Odpowiedź po sprostowaniu: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 4
Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o odporności na przenikanie mikroorganizmów na mokro- 6.0 IB? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak

Pytanie 5
Część nr 1, poz. 5
Część nr 14, poz. 1-7
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów sklasyfikowanych jako zestawy zabiegowe spełniające definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz

ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37?

~~Odp.: Jak w SWZ.~~

Odpowiedź po sprostowaniu: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 6
Część 1
Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 75 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem min. 60 cm x 80 cm
- 1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów?
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2) i zdolności absorbcji płynu min. 155 ml/m2 zgodnie z normą EN ISO 9073-6. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm) i zdolności absorbcji płynu min. 385 ml/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Odporność na rozerwanie w stanie mokrym min. 130 kPa wg normy EN13938-1. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 7
Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem min. 60 cm x 80 cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
- 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
- 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep?
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2), chłonność warstwy zewnętrznej min. 155 ml/m2 zgodnie z normą EN ISO 9073-6, odporność na rozerwanie w stanie mokrym min. 130 kPa wg normy EN 13938-1.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 8

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem min. 60 cm x 80 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
- 1 serweta operacyjna 150 cm x 180 cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
- 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
- 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
- 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2) i chłonności warstwy zewnętrznej min. 155 ml/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm (+/- 1 cm), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2) chłonności warstwy zewnętrznej min. 385 ml/m2, odporność na rozerwanie w stanie mokrym min. 130 kPa wg normy EN 13938-1. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 9

Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie min. 75 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm, wzmocnienie min. 60 cm x 80 cm
- 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm

- 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji?
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74 g/m2, odporność na rozerwanie w stanie mokrym min. 130 kPa wg normy EN 13938-1, chłonność warstwy zewnętrzne min. 155 ml/m2 zgodnie z normą EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 10
Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie min. 75 cm x 90 cm
- 4 ręczniki 20 cm x 30 cm
- 1 fartuch chirurgiczny SMMS standardowy 130cm
- 1 fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 150cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnieni min. 60 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione w polu krytycznym 75 cm x 90 cm, wzmocnienie 20cm x 50 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona w polu krytycznym 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, wzmocnienie 20 cm x 50 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona w polu krytycznym 150 cm x 250 cm, wzmocnienie 20 cm x 50 cm?
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego :włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni serwet 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Serwety do obłożenia pacjenta wzmocnione łata chłonną w polu krytycznym, całkowita gramatura materiału w obrębie łat chłonnych 109 g/ m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na rozerwanie w stanie mokrym min. 270 kPA wg normy EN 13938-1, zdolność absorbcji płynu min. 475 ml/m2 wg normy EN ISO 9073-6. Serwety spełniają klasę 1 palność CFR 1610. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.
Fartuchy z zakładanymi połami, zachowujące sterylny obszar na plecach, wiązane na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Fartuch standardowy z włókniny polipropylenowej min. 35g/m2, fartuch wzmocniony min. 75g/m2.
Fartuch w rozmiarze 150 cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Wewnątrz rękawa znajduje się taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów.
Odporność na przenikanie cieczy dla fartucha wzmocnionego min. 145 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho min. 155 kPa, odporność na rozerwanie na mokro min. 144 kPa.

Odporność na przenikanie cieczy dla fartucha standardowego min. 35 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho min. 160 kPa, odporność na rozerwanie na mokro min. 140 kPa.
Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795:2019- zgodne z tą normą.
Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nazwę zestawu, nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nazwę zestawu, nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR.

Odp.: Jak w SWZ

Pytanie 11
Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość osłony na kończynę dolną o wymiarach 32 x 120 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10 cm x 50 cm. Osłona na kończynę wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny.
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795 : 2019 Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 12
Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość osłony na kończynę dolną o wymiarach 50 x 110 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795 : 2019. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Pakowana a'2 szt.

Odp.: Nie

Pytanie 13
Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie min. 75 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie min. 60 cm x 140 cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
- 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
- 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep?
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2), zdolność absorbcji ciechy min. 173 ml/m2 zgodnie z EN ISO 9073-6, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 180 kPa, zgodnie z normą EN ISO 13938-1.
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane

producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odp.: Jak w SWZ.

Zadanie nr 2

Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego skład wchodzi:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 120x140cm
- 1 serweta na kończynę dłoń/stopa 200x300cm dwuwarstwowa, z otworem samouszczelniającym o średnicy 3 cm umieszczonym centralnie?
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Gramatura całkowita laminatu 48 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Odporność na rozerwanie w stanie mokrym min. 113 kPa wg EN ISO 13938 – 1, zdolność absorbcji cieczy min. 145 ml/m2 zgodnie z EN ISO 9073-6.
Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 15
Cześć 2, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm.
Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Odp.: Jak w SWZ.

Zadanie nr 3


Pytanie 16
Część nr 3, poz. 1
Część nr 4, poz. 1-3
Część nr 5, poz. 1-7
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów serwet do operacji ginekologicznych oraz pojedynczych, jałowych serwet do operacji wykonanych w części niewzmocnionej z laminatu 2- warstwowego o odporności na rozerwanie w stanie mokrym min. 103 kPa? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe zestawy.

Pytanie 17
Część 3:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego skład wchodzi:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie min. 60 cm x 80 cm
- 1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm
- 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm
- 1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm?
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2), zdolność absorbcji cieczy min. 155 ml/m2 według EN ISO 9073-6, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 180 kPA według EN ISO 13938-1.
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Jak w SWZ.


Pytanie 18
Część 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw w składzie:
1. Serweta operacyjna z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego L2 w rozmiarze 90cmx75cm – 1 sztuka
2. Serweta operacyjna główna z laminatu dwuwarstwowego L2 w rozmiarze 275cmx200cm z otworem 10cmx15cm ze zintegrowanymi nogawicami i workiem na płyny – 1 sztuka
3. Ręczniczki włókninowe 40 g 20x40 cm – 2 sztuki
4. Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 145cmx80cm z warstwa chłonną 76x85cm – 1 sztuka
5. Serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 190cmx150cm – 1 sztuka (owinięcie zestawu)
6. Taśma przylepna w rozmiarze 50cmx9cm – 1 sztuki

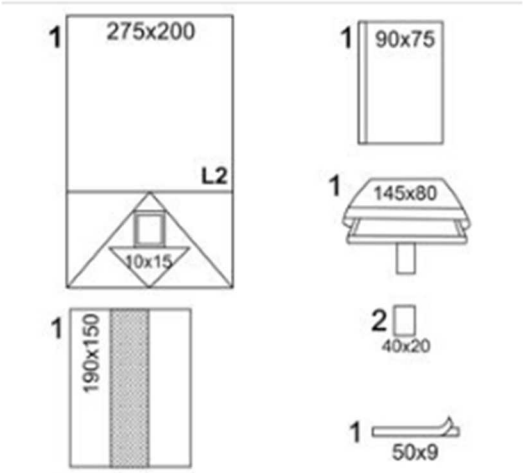

Parametry zestawu:
Serwety L2: gramatura 55g/m2, skład: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, chłonność: 218,45 ml/m2
Zgodne z normą EN 13795 -1 :2019. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min.2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Zestaw opakowany folia –papier, wewnętrzne owinięcie w serwetę zestawu.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 19
Część 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%, o składzie:
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm
1 x serweta ginekologiczna o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
4 x ręcznik chłonny włókninowy o wymiarach 30 cm x 30 cm?

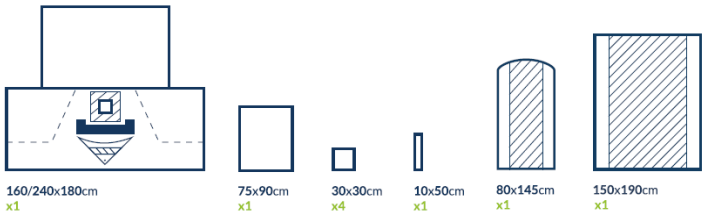

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 20
Pakiet 3 poz.1
Czy Zamawiający dopuści Zestaw ginekologiczno-urologiczny w składzie:
1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
1 x serweta pod pośladki 75x100cm;
4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
1 x serweta ginekologiczno-urologiczna 300/220x279cm zintegrowana z nogawicami, z trapezowym otworem 9/13x15cm otoczonym taśmą samoprzylepną, z torbą na płyny z filtrem i portem;
1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa

Odp.: Jak w SWZ.

Zadanie nr 4

Pytanie 21
Część 4:
Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem okrągłym nieprzylepnym o wymiarach 45 cm x 75 cm, otwór 6 cm? Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 40,2 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 95 kPa, według EN ISO 13938-1.
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795:2019. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odp.: Jak w SWZ

Pytanie 22
Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem owalnym przylepnym o wymiarach 120 cm x 150 cm, otwór 7 cm x 10 cm? Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura

laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2), wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 180 kPa, według EN ISO 13938-1.
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795:2019. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odp.: Nie.

Pytanie 23
Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem okrągłym przylepnym o wymiarach 50 cm x 60 cm, otwór 6 cm? Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2), wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 180 kPa, według EN ISO 13938-1.
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795:2019. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 24
Pakiet 4 poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści Materiał dwuwarstwowy laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności
- Gramatura 60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2)
- Otwór z taśmą przylepną ułatwiającą mocowanie serwety
- Opakowanie papier-folia

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 25
Pakiet 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści Serwetę 50x75cm z otworem przylepnym 5cm?

Odp.: Nie.

Pytanie 26
Pakiet 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści Serwetę 90x150cm z otworem przylepnym 8cm?

Odp.: Nie.

Pytanie 27
Pakiet 4 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści Serwetę 50x75cm z otworem przylepnym 5cm?

Odp.: Nie.

Pytanie 28
Pakiet 4, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści serwety z laminatu o gramaturze 60g/m2 i o odporności na rozerwanie w stanie mokrym 99,4 kPa?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 29
Pakiet 4, 5
Czy Zamawiający dopuści opakowanie pośrednie foliowe, opakowanie transportowe karton.

Odp.: Nie.

Pytanie 30
Pakiet 4 poz. 1-7
Czy Zamawiający dopuści Materiał dwuwarstwowy laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności

- Gramatura 60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2)
- Otwór z taśmą przylepną ułatwiającą mocowanie serwety
- Opakowanie papier-folia

Odp.: Jak w SWZ.

Zadanie nr 5

Pytanie 31
Część 5:
Poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 2-warstwowa 75 cm x 90 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2), odporność na wypychanie na mokro min. 185 kPA wg EN ISO 13938-1.
Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 32
Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej 150 cm x 240 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na wypychanie na mokro min. 185 kPA wg EN ISO 13938-1.
Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 : 2019. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 33
Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej 75 cm x 90 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na wypychanie na mokro min. 185 kPA wg EN ISO 13938-1.
Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 : 2019. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 34
Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej 75 cm x 75cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na wypychanie na mokro min. 185 kPA wg EN ISO 13938-1.
Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 : 2019. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 35
Poz. 8: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145cm, serweta w kształcie worka? Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 : 2019. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Gramatura laminatu w strefie chłonnej min. 85 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na wypychanie na mokro min. 150 kPA wg EN ISO 13938-1.

Odp.: Dopuszcza, pozostałe jak w SWZ

Pytanie 36
Pakiet 5, pozycja 1-7 - Czy Zamawiający dopuści serwety z laminatu o gramaturze 60g/m2 i o odporności na rozerwanie w stanie mokrym 99,4 kpa?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 37
Część 5 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści Serwetę 45x45 cm?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 38
Pakiet 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 39
Część 5 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści Serwetę 50x70 cm ?

Odp.: Jak w SWZ

Pytanie 40
Pakiet 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odp.: Jak w SWZ

Pytanie 41
Część 5 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie 76 x 85 cm?

Odp.: Tak, pozostałe jak w SWZ

Pytanie 42
Część 5 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści gramaturę w strefie chłonnej min. 77 g/m2?

Odp.: Nie.

Pytanie 43
Część 5 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie 60 x 142 cm?

Odp.: Nie.

Pytanie 44
Pakiet 5, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonaną z niepiaskowanej folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 90 cm x 75 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 150 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 45
Część nr 5
Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 37,5 x 45 cm?

Odp.: TAK.

Pytanie 46
Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo posiadającej wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145 cm?

~~Odp.: Jak w SWZ.~~

Odpowiedź po sprostowaniu: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zadanie nr 6

Pytanie 47
Część 6
Czy Zamawiający dopuści • Sterylne, jednorazowego użytku
- Materiał - wzmacniana wysoko chłonna, niepyląca włóknina celulozowa
- Gramatura 70 g/m2
- Pakowane a' 2 szt.
- Wymiar 30 x 40 cm
- Termin przydatności do użycia 5 lat od daty produkcji
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Odp.: Jak w SWZ

Pytanie 48
Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści ręczniki z włókniny spunlace 56g/m^2, pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Nie.

Pytanie 49
Część 6:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych ręczników wysokochłonnych o wymiarach 30 x 40 cm (opakowanie a'2 szt)? Sterylne ręczniki o bardzo wysokiej chłonności. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Wyrób higieniczny. Gramatura min. 60 g/m2.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zadanie nr 7

Pytanie 50
Część 7
Czy Zamawiający dopuści : Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m2
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
• 1 serweta samoprzylepna 50 x 80cm;
• 1 kieszeń dwukomorowa samoprzylepna 30 x 40cm;
• 1 włókninowa OP taśma 10 x 50cm;
• 1 serweta główna w kształcie litery T 250/150x300cm z otworem 35 x 35cm wypełnionym folią
chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w
kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do
ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;


Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 51
Część 7:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o poniższym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie min. 60 x 140
- 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej ze zintegrowaną folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torba na płyny, w tym z zaworem do podłączenia drenu serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych?
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Gramatura całkowita laminatu 48 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność materiału na przenikanie cieczy min. 125 cm/H2O, odporność na rozerwanie w stanie mokrym min. 185 kPa, w stanie suchym 175 kPa. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej.
Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odp.: Jak w SWZ.


Pytanie 52
Pakiet 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H2O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420%, o składzie:
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm

• 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów z 1 zaworem
• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm z włókniny spunlace 80g/m2
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
• 4 x ręcznik chłonny włókninowy o wymiarach 30 cm x 30 cm
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

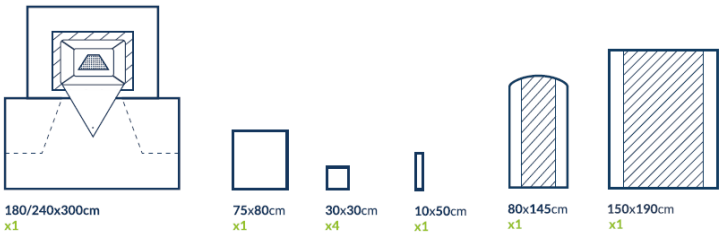

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 53
Pakiet 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Skład:
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm
• 1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 360° o wymiarach 80 cm x 90 cm, z dwoma zaworkami
• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, z włókniny spunalce 80g/m2
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
• 4 x ręcznik chłonny włókninowy o wymiarach 30 cm x 30 cm
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

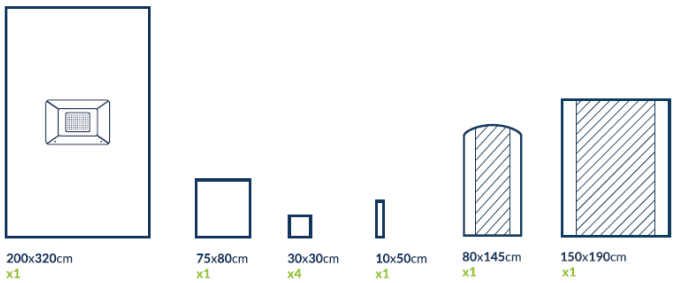

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 54
Cześć 7
Czy Zamawiający dopuści 4 samoprzylepne naklejki typu TAG.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 55
Część 7
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze karton- bez wskaźnika sterylizacji?

Odp.: Nie.


Pytanie 56
Pakiet 7 poz.1
Czy Zamawiający dopuści w składzie:
4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm
1 x taśma samoprzylepna 9x50cm
1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
1 x serweta dla noworodka 75x120cm
1 x Serweta do cięcia cesarskiego z folią operacyjną z otworem, z torbą na płyny, 4 podwójnymi
organizatorami przewodów i 2 portami do ssaka 180/250 x 330cm, folia 36x36cm, otwór 18x16cm, torba 72x72m
1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa

Odp.: Jak w SWZ.

Zadanie nr 8

Pytanie 57
Część 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw w składzie:

1. Serweta operacyjna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g w rozmiarze 130cmx90cm – 1 sztuka
2. Serwetka włókninowa w rozmiarze 80cmx60cm gramatura 40g – 1 sztuka
3. Serweta operacyjna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g w rozmiarze 150cmx90cm – 1 sztuka (owinięcie zestawu)
4. Serwetka włókninowa w rozmiarze 25cmx20cm gramatura 40g – 6 sztuk
5. Podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową 90cmx60cm – 1 sztuka
6. Podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową 60cmx60cm – 1 sztuka

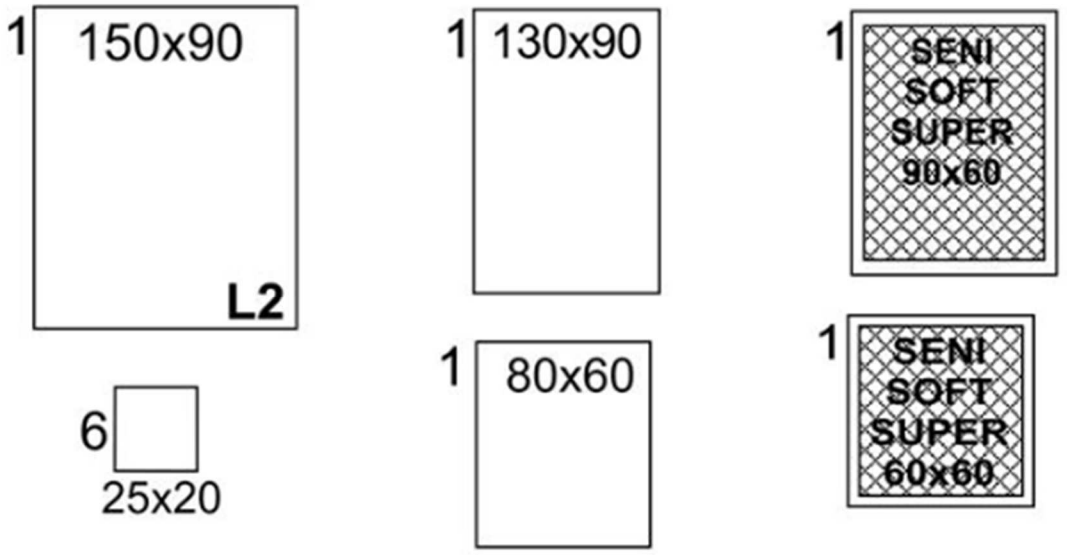

Parametry zestawu:
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier". Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze karton typu dyspenser oraz karton transportowy.
Serweta materiał: L2: gramatura 55g/m2, skład: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, klej, Chłonność: 218,45 ml/m2
Odporność na przenikanie cieczy – min. 309,8 cm H2O.
Odporność na wypychanie na sucho – 247 kPA , na mokro – 241 kPA.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 58
Część 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie jak powyżej, ale serwety operacyjne wykonane są z laminatu L3?
Serweta L3: (gramatura 73g/m2, laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej, i włókniny polipropylenowej, odporność na przenikanie cieczy: 191 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 98 N rozciąganie na mokro – 63 N, wypychanie na sucho 108 kPa, na mokro 100 kPa, chłonność 335,6%
Zgodne z normą EN 13795 -1 :2019. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min.2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Zestaw opakowany folia –papier, wewnętrzne owinięcie w serwetę zestawu.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 59
Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w

obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 87,6/85,4N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność warstwy zewnętrznej 304%, o składzie:
• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
• 1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm
• 1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm
• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
• 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 9

Pytanie 60
Część 9
Czy Zamawiający ma na myśli podkład 90x170 cm?

Odp.: Tak.

Pytanie 61
Część 9
Czy Zamawiający oczekuje podkładu 90x170 cm tj. warstwa chłonna plus włókninowe skrzydła boczne?

Odp.: Tak.

Pytanie 62
Pakiet 9, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści podkład z niebieską folią jako warstwą spodnią?

Odp.: Tak.

Pytanie 63
Pakiet 9, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem chłonnym zawierającym dodatkowo superabsorbent?

Odp.: Tak.

Pytanie 64
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 9 poz. 1 podkładów chłonnych podfoliowanych, nieprzemakalnych, z wkładem chłonnym składającym się z pulpy celulozowej + SAP, o chłonności min 596 g , wymiar 60x60 cm, rozmiar wkładu chłonnego ok. 55x55cm, folia PE w kolorze niebieskim ?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 65
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 9 poz. 2 podkładów chłonnych nieprzepuszczających wilgoci, podfoliowany, w rozmiarze 60x90cm z wkładem chłonnym składającym się z pulpy celulozowej + SAP, chłonność min. 1000 g, rozmiar wkładu chłonnego ok 85 x 55, folia PE w kolorze niebieskim?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 66
Pakiet 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności minimum 1326g?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 67
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 3 podkładów chłonnych podfoliowanych, nieprzemakalnych, niesterylnych, z pulpą celulozową + SAP o chłonności 1200 ml , wymiar 90x180 cm, wymiar warstwy chłonnej min. 74cm x 74cm, z zakładkami, folia PE w kolorze niebieskim?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 68
Część 9, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści podkłady z zakładkami o wymiarach 70 x 180 cm, chłonności 1750 ml, całkowicie podfoliowanych?

Odp.: Jak w SWZ.

Zadanie nr 10

Pytanie 69
Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny wykonany z chłonnego wkładu z waty bawełnianej +SAP oraz folii izolacyjnej, wkład chłonny jest otoczony warstwą celulozy, a warstwa zewnętrzna (kontaktowa z raną) to 100% włóknina, waga 20g +/-2g, chłonność ≥280ml?

Odp.: Nie.

Pytanie 70
Pakiet 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem z pulpy celulozowej z absorbentem?

Odp.: TAK, pozostałe jak w SWZ

Pytanie 71
Pakiet 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o wadze 77g+/-5g i chłonności 1655g?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 11

Pytanie 72
Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze materiału podstawowego 35g/m2?

Odp.: Nie.

Pytanie 73
Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający standardowe zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?

Odp.: Nie, Jak w SWZ.

Pytanie 74
Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 75
Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa dla rozmiaru L 76 cm, XL 77 cm, XXL 76 cm?

Odp.: Nie, jak w SWZ.

Pytanie 76
Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy min. 102 cm H2O?

Odp.: Nie.

Pytanie 77
Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści ręczniki z włókniny spunlace w rozmiarze 30x30cm?

Odp.: Nie.

Pytanie 78
Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMS?

Odp.: Nie.

Pytanie 79
pakiet 11 poz. 1
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie fartuchów o następujących parametrach :
Fartuch chirurgiczny rozm. zapinany przy szyi na rzep , rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym 100%. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiadający zapięcie na rzep , bez możli wości zapięcia na taśmę wielokrotnego użytku, oznakowanie rozmiaru fartucha w postaci nadruku. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 130 cm H2O, odporność na przesiąkanie drobnoustrojów na mokro BI =6. Wewnątrz opakowania 2 ręczniki do rąk.

Długość rękawa fartucha od wycięcia pod szyją do mankietu analogicznie do rozmiarów fartucha.
a) M – dł. rękawa 58 cm
b) L - dł. rękawa 60 cm
c) XL - dł. rękawa 60 cm
d) XXL rękaw dł. 64 cm

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 80
Część 11
Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne: • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach, gramatura wzmocnienia 40g/m2
• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka, z tyłu zapięcie na rzep
• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
Wewnątrz opakowania 2 ręczniki do rąk
• Zgodność z normą EN-13795 1-3; Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 148 cm H2O
- oznakowanie rodzaju fartucha w postaci nadruku na fartuchu widocznego przed rozłożeniem oraz wyraźne oznaczenie na opakowaniu jednostkowym,
a) M – dł. rękawa 78 cm
b) L - dł. rękawa 81 cm
c) XL - dł. rękawa 82 cm
d) XXL rękaw dł. 87 cm

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 81
Część 11:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach.
Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów.
Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2.
Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina SMS. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR część 1610, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB = 6, odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O . Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR.
Rozmiar fartucha S/M, L, XL. XXL.
Długość rękawa od pachy do mankietu:

a) S/M – od 60 cm do 62 cm
b) L – od 60 cm do 62 cm
c) XL - od 62 cm do 65 cm
d) XXL - od 62 cm do 65 cm

Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.

Odp.: Jak w SWZ.

Zadanie nr 12

Pytanie 82
Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: "Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch watrstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ±5g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie."?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 83
Pakiet 12, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: "Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch watrstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 190 kg. Waga całkowita podkładu 295 g ±5g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie."?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 84
Pakiet 12, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 85
Pakiet 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: "Podkład chłonny w rozmiarze 40 x 60 cm z wkładem chłonnym 34 cm x 54cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 3,12 g, dwóch warstw celulozy 5,06 g, pulpy celulozowej z superabsorbent SAP 25,54 g (pulpa) + 3 g (SAP), niebieskiej folii PE 5,28 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 923,4 g. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie."?

Odp.: Tak.

Pytanie 86
Pakiet 12, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: "Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch watrstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 190 kg. Waga całkowita podkładu 295 g ±5g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie."?

Odp.: Jak w SWZ.

Zadanie nr 13

Pytanie 87
Pakiet 13 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach: Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Odporność na rozciąganie: MD (N/50 mm) > 39 CD (N/50 mm) > 50. Rozmiar: L (długość 120cm+/-3cm, obwód 140cm+/-2cm), XL (długość 135cm+/-3cm, obwód 150cm+/-2cm)?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 14

Pytanie 88
Część nr 14
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie pojemnik na igły i ostrza na min. 25 szt. oraz opatrunek pooperacyjny w rozmiarze 15 x 8 cm?Pozostały skład bez zmian.

Odp.: Tak.

Pytanie 89
Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie pojemnik plastikowy 250ml w rozmiarze 9,3 x 5,4 cm oraz pojemnik plastikowy 500 ml w rozmiarze 8 x 8 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Tak.

Pytanie 90
Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu pakowanego w opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny?

Odp.: Tak.

Pytanie 91
Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie niezapakowaną strzykawkę 10 ml? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Tak.

Zadanie nr 15

Pytanie 92
pakiet 15 poz. 1
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie fartuchów o następujących parametrach :
Fartuch chirurgiczny zapięciem w okolicy karku na rzep o długości 11 cm cm na jednej części fartucha i 9 cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk z rozmiarówką, zgodny z normą PN-EN 13795-1:2019 Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach min. 30 cm x 30 cm chłonne o gramaturze min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach min.60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 35 cm H_2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.80,6 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL,XXXL. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 93
Część 15
Czy Zamawiający dopuści Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne: • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim,
• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka, z tyłu zapięcie na rzep o długości 12 cm na jednej części fartucha i 6 cm na drugiej części fartucha;
• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
Wewnątrz opakowania 2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm • (Materiał - wzmacniana wysoko chłonna, niepyląca włóknina celulozowa
• Gramatura 70 g/m2)
• Zgodność z normą EN-13795 1-3; Odporność na przenikanie cieczy 61 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 128,6 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 142,00 kPa
- oznakowanie rodzaju fartucha w postaci nadruku na fartuchu widocznego przed rozłożeniem oraz wyraźne oznaczenie na opakowaniu jednostkowym,
Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm, 3 naklejki typu TAG;

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 94
Część 15:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym.
Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina SMS.
Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR część 1610, odporność na przenikanie cieczy min. 35 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPA, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 82,1 N. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR .
Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Rozmiar fartucha S/M, L, XL. XXL.

Odp.: Jak w SWZ.

Zadanie nr 16

Pytanie 95
Część 16
Czy Zamawiający dopuści SKŁAD ZESTAWU:

a) 2 serwety z miękkiej włókniny kompresowej – 80 x 60cm
b) 1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 60 x 60cm
c) 1 kocyk flanelowy 160 x 75cm
d) 1 czapeczka bawełniana dla noworodka

Odp.: Jak w SWZ.

Pytanie 96
Pakiet 16 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw dla noworodka z serwetkami włókninowymi o wymiarach 25 x 25 cm (zamiast 25 x 20 cm)? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: Nie.

Pytanie 97
Część 16
Czy Zamawiający wymaga podkładu chłonnego o chłonności 1400g?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 98
Czy Zamawiający wymaga, by podkład oznaczony był nazwą własną lub indeksem/symbolem pozwalającym na jego identyfikację z kartą danych technicznych potwierdzającą jego chłonność?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 99
Czy Zamawiający wymaga serwetek włókninowych 40g 25x20 cm?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 100
Czy Zamawiający wymaga terminu ważności 5 lat od daty produkcji?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 101
Czy Zamawiający podtrzymuje, że wymaga, by zestaw dla noworodka zapakowany był w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki, zgrzew w kształcie litery V ułatwiający aseptyczne, bezpyłowe otwarcie?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 102
Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie powyższego zapisu.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Marian Świerz
Data: 2026.08.26 14:30:13 CEST